

Thermomètre de pénétration / contact

testo 905

Lecture aisée grâce à la tête pivotante

Etendue de mesure élevée


Mesure à hautes températures, jusqu'à 500 °C
(courte durée)

Temps de réponse très rapide

Simple d'utilisation

Grand écran

Fonction Auto-Off

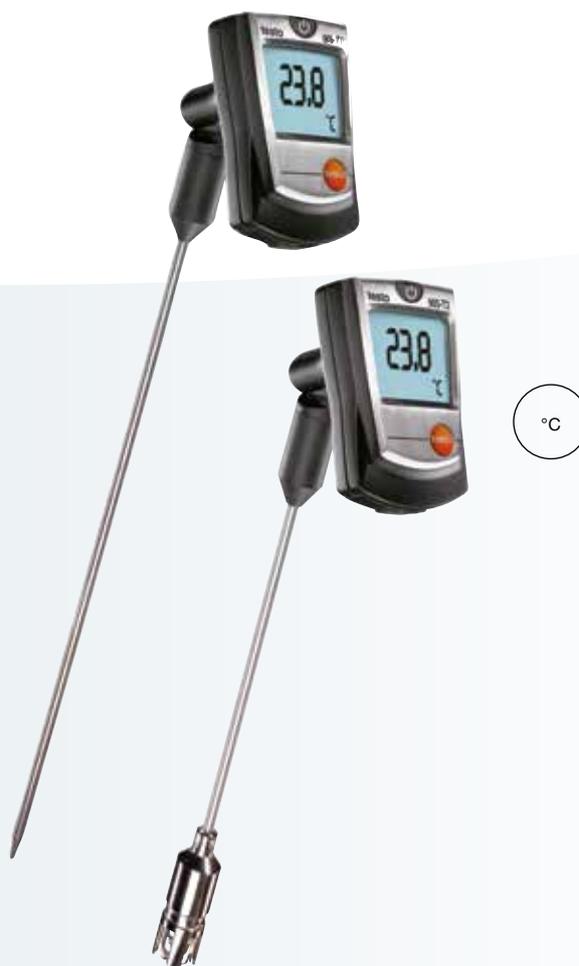

Le testo 905-T1 est l'un des mini-thermomètres d'immersion les plus rapides avec une large étendue de mesure de -50 à +350°C, à court terme (1-2 mn) jusqu'à +500°C.

Le thermomètre possède un capteur professionnel (thermocouple type K). Ce thermocouple a une bonne précision surtout pour des températures élevées.

Le testo 905-T2 est un mini-thermomètre de contact avec une large étendue de mesure de -50 à +350°C, à court terme (1-2 mn) jusqu'à +500°C. Sa large tête de mesure à thermocouple K à lamelles souples garantit un temps de réponse très rapide et une précision élevée par un bon contact de la sonde.

Les 2 appareils possèdent une tête pivotante qui permet de lire les résultats dans toutes les positions.

Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 905-T1

testo 905-T1; thermomètre de pénétration avec clip de fixation, fixation en gaine, pile et mode d'emploi

Réf. 0560 9055



testo 905-T2

testo 905-T2; thermomètre de contact avec sonde à lamelles souples, clip de fixation et pile

Réf. 0560 9056



Caractéristiques techniques

	testo 905-T1	testo 905-T2
Etendue de mesure	-50 ... +350 °C (à court terme jusqu'à 500 °C)	-50 ... +350 °C (à court terme jusqu'à 500 °C)
Précision : ± 1 digit	± 1 °C (-50 ... +99.9 °C) ± 1 % v.m. (étendue restante)	(± 1 °C ± 1 % v.m.)
Résolution	0.1 °C	0.1 °C
Température d'utilisation	0 ... +40 °C	0 ... +40 °C
Température de stockage	-20 ... +70 °C	-20 ... +70 °C
Type de piles	3 piles AAA	3 piles AAA
Autonomie	1000 h	1000 h
Temps de réaction	env. 10 sec.	env. 5 sec.
Type de réponse	t ₉₉ (dans l'eau)	t ₉₉
Affichage	LCD ; 1 ligne	LCD ; 1 ligne
Poids	80 g	80 g

Accessoires pour testo 905-T1

Réf.

Certificat d'étalonnage raccordé en température pour sonde d'ambiance / d'immersion ; point d'étalonnage : 0 °C	0520 0062	
Certificat d'étalonnage raccordé en température pour sonde d'ambiance / d'immersion ; point d'étalonnage : -18 °C	0520 0061	
Certificat d'étalonnage raccordé en température pour sonde d'ambiance / d'immersion ; point d'étalonnage : +60 °C	0520 0063	
Certificat d'étalonnage raccordé en température pour sonde d'ambiance / d'immersion ; points d'étalonnage : -18 °C, 0 °C et +60 °C		

Accessoires pour testo 905-T2

Réf.

Certificat d'étalonnage raccordé en température Etalonnage à 1 point pour thermomètre avec sonde de contact ; point d'étalonnage : +120 °C	0520 0073	
Certificat d'étalonnage raccordé en température Etalonnage à 1 point pour thermomètre avec sonde de contact ; point d'étalonnage : +60 °C	0520 0072	
Certificat d'étalonnage raccordé en température Appareil de mesure avec sonde de contact; points d'étalonnage : +60 °C, +120 °C et +180 °C	0520 0071	
Certificat d'étalonnage raccordé en température Appareil avec sonde de contact ; points d'étalonnage au choix de -15 ... +480 °C	0520 0121	

Testo S.à.r.l.
Immeuble Testo
19, rue des Maraîchers - CS 30100
57602 FORBACH Cedex
Tél.: 03 87 29 29 29
Fax: 03 87 29 29 18
info@testo.fr